


Configuration Analyseur Spectral SP6800

- 3 lasers: 405 nm (60mW) / 488 nm (40mW) / 638 nm (60mW)
- 16 groupes de fluorochromes analysables simultanément

Laser BLEU
488nm

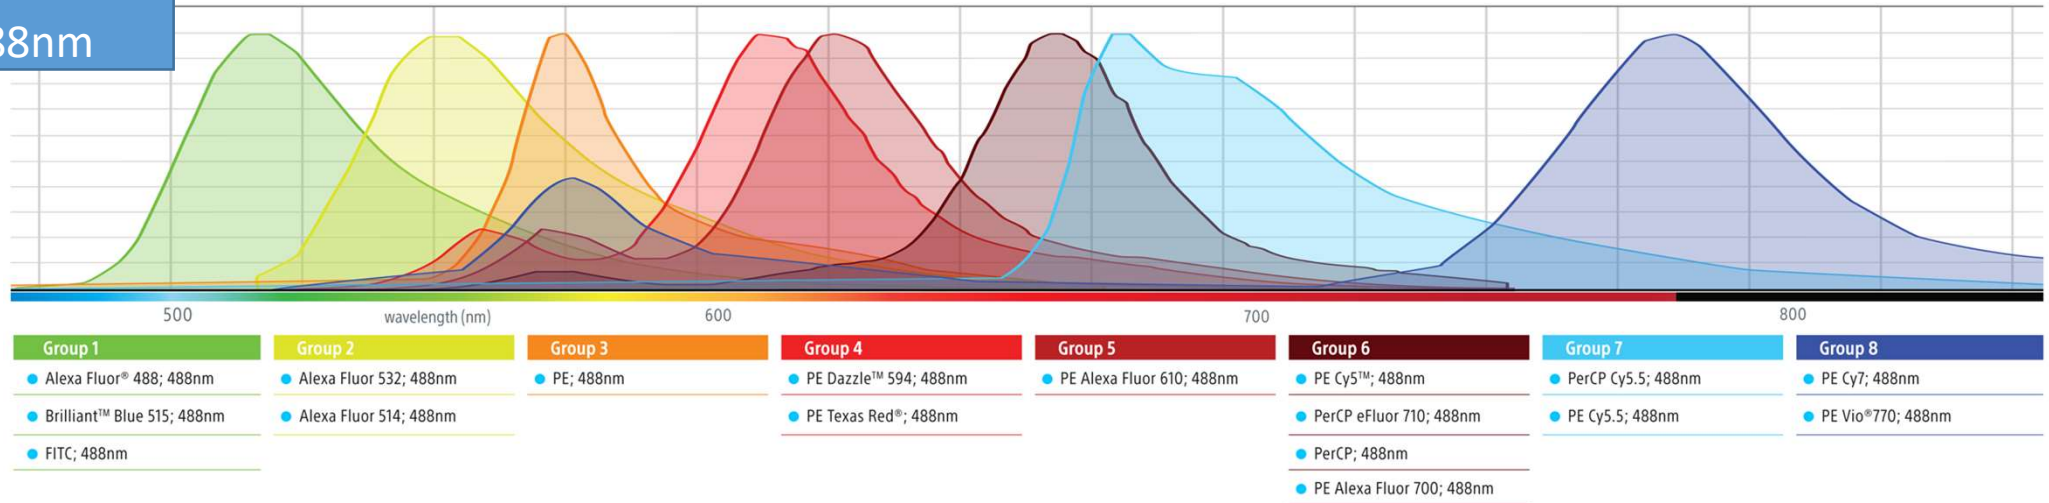

Lasers VIOLET 405nm
et ROUGE 638nm

